



Создаем лучшее,
сохраняя хорошее

ООО «Измерительная Техника»

Преобразователи измерительные промышленные П-216.3МИ, П-216.4МИ

Руководство по эксплуатации



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3
2 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	4
2.1 Принцип работы преобразователей.....	4
2.2 Конструкция преобразователей	5
3 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7
4 ПОДГОТОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ К РАБОТЕ	7
4.1 Порядок установки.....	7
4.2 Монтаж	8
4.3 Подготовка к работе с персональным компьютером	10
5 РАБОТА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ.....	10
5.1 Общие указания.....	12
5.2 Режимы работы преобразователя	12
5.3 Режим «ИЗМЕРЕНИЕ»	12
5.4 Режим «ГРАДУИРОВКА»	14
5.5 Режим «УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ»	19
5.6 Режим «КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ»	25
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	25
7 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	26
ПРИЛОЖЕНИЕ А	29
Схемы электрических соединений преобразователя П-216.3МИ	
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	31
Схемы электрических соединений преобразователя П-216.4МИ	
ПРИЛОЖЕНИЕ В	35
Значения pH рабочих эталонов (ГОСТ 8.134-98)	
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	36
Алгоритмы работы преобразователей.....	

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные промышленные П-216.3МИ, П-216.4МИ (далее - преобразователи), предназначены для измерения электродвижущей силы (ЭДС) первичных измерительных преобразователей (далее - электродная система), применяемых для потенциометрических измерений, преобразования измеренной величины в значение показателя активности ионов водорода (рН), а также индикации величины ЭДС или значения рН на цифровом табло. В комплекте с первичным термопреобразователем сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006 с номинальной статической характеристикой преобразования 100П (Pt 100) преобразователи могут также производить измерение и выводить на цифровое табло значение температуры анализируемой среды.

Преобразователи соответствуют ГОСТ 27987-88 и могут применяться для непрерывных потенциометрических измерений в технологических водных растворах и пульпах (в т. ч. при анализе воды с низкой электропроводностью) в системах контроля и управления технологическими процессами различных видов экономической деятельности. Совместно с различной арматурой и электродными системами преобразователи могут входить в состав анализаторов, обеспечивающих проведение измерений в открытых и закрытых емкостях, в трубопроводах и системах проточного пробоотбора.

В качестве электродной системы могут быть использованы любые электроды промышленного назначения, установленные в соответствующую арматуру (например, БГ-1ИТ, ДПг-4М, ДМ-5М и др.). Электродная система может быть подключена к преобразователю по дифференциальной и не-дифференциальной схеме включения.

Преобразователи формируют электрические непрерывные аналоговые выходные сигналы постоянного тока по ГОСТ 26.011-80, пропорциональные показателю активности анализируемой среды или ЭДС электродной системы. Преобразователи могут быть подключены к персональному IBM-совместимому компьютеру.

Преобразователь исполнения П-216.3МИ имеет встроенный входной дифференциальный усилитель с двумя высокоомными входами.

Преобразователь исполнения П-216.4МИ состоит из выносного входного дифференциального усилителя с двумя высокоомными входами ВУ-216.4МИ и блока преобразования БП-216.4МИ.

В зависимости от номинального значения питающего напряжения переменного тока преобразователи выпускаются в двух исполнениях: на 220 В (основное исполнение) и на 36 В (по требованию заказчика).

Основные технические характеристики, методика поверки и сведения по градуировке преобразователей изложены в формуляре
ГРБА.421221.003ФО.

2 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1 Принцип работы преобразователей

2.1.1 В основу работы преобразователей положен потенциометрический метод измерений величины pH и Eh растворов.

При измерениях pH (или Eh) растворов используется электродная система, состоящая из измерительного электрода и электрода сравнения. Эти электроды могут представлять собой как раздельные устройства, так и быть объединены в одном корпусе (комбинированный электрод). Электродная система, погруженная в анализируемый раствор, развивает электродвижущую силу (ЭДС), пропорциональную показателю активности ионов водорода (pH) или соотношению концентраций окисленной и восстановленной форм редокс-системы.

ЭДС электродной системы зависит также от температуры анализируемого раствора. Для учета этого влияния (термокомпенсации) в преобразователях предусмотрен канал измерения температуры. В качестве первичного измерительного преобразователя используется термодатчик, выполненный на основе терморезистора.

Расчет значения pH осуществляется по следующей формуле:

$$\text{pH} = \text{pH}_i - (E - E_i) / K_s \cdot (54,1 + 0,198 t), \quad (1)$$

где E – измеренная ЭДС электродной системы, мВ;

pH_i – координата изопотенциальной точки электродной системы;

E_i – координата изопотенциальной точки электродной системы, мВ;

K_s – доля, которую составляет реальная крутизна электродной характеристики от теоретического значения, равного $(54,1 + 0,198 t)$;

t – температура раствора, измеренная при помощи термодатчика или введенная вручную, °C.



Изопотенциальной называется точка, в которой ЭДС электродной системы не зависит от температуры, а соответствующие ей значения « pH_i » и « E_i » называются координатами изопотенциальной точки.

2.1.2 ЭДС электродной системы измеряется и преобразуется в значение pH, которое выводится на табло преобразователей. Кроме этого, на табло преобразователей выводятся результаты измерений ЭДС электродной пары и температуры анализируемой среды в единицах мВ и °C соответственно.


2.1.3 Значение pH или ЭДС электродной системы может преобразовываться в унифицированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока от 0 до 5 mA или от 4 до 20 mA и по линии связи передается в системы контроля и управления.

2.2 Конструкция преобразователей

Общий вид преобразователя П-216.3МИ (блока преобразования БП-216.4МИ) приведен на рисунке 1. Общий вид усилителя входного ВУ-216.4МИ, входящего в комплект П-216.4МИ приведен на рисунке 2.

Конструктивно измерительный преобразователь П-216.3МИ (блок преобразования БП-216.4МИ) представляет собой корпус с прозрачной защитной герметично закрывающейся крышкой. На лицевой панели расположены цифровое табло и панель управления.

В нижней части корпуса находится распределительная коробка с клеммами для подключения сигнальных линий электродов, питания и исполнительных устройств.

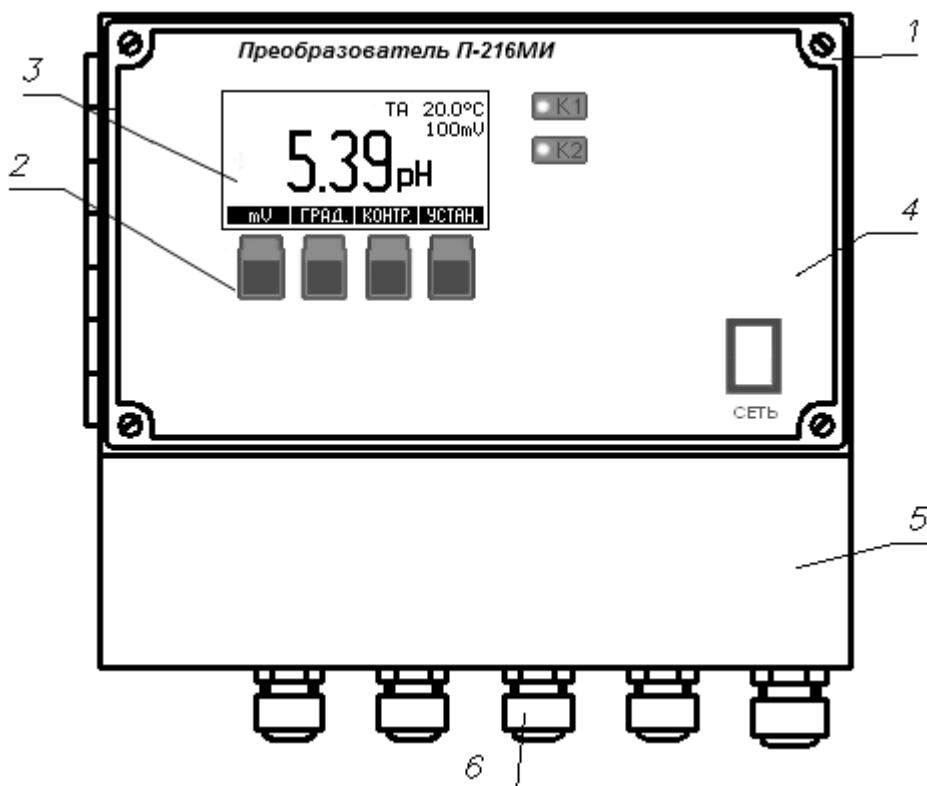


1. Корпус. 2. Панель управления. 3 Цифровое табло. 4. Прозрачная защитная крышка.
5. Распределительная коробка. 6. Гермоводы.

Рисунок 1 – Преобразователь П-216.3МИ (блок преобразования
БП-216.4МИ)

Распределительная коробка закрывается крышкой с резиновым уплотнением.

Кабели вводятся в распределительную коробку преобразователя П-216.3МИ (блока преобразования БП-216.4МИ) и усилителя входного ВУ-216.4МИ через соответствующие гермоводы.

Конструктивно усилитель входной ВУ-216.4МИ представляет собой коробку с герметичной крышкой и гермоводами.

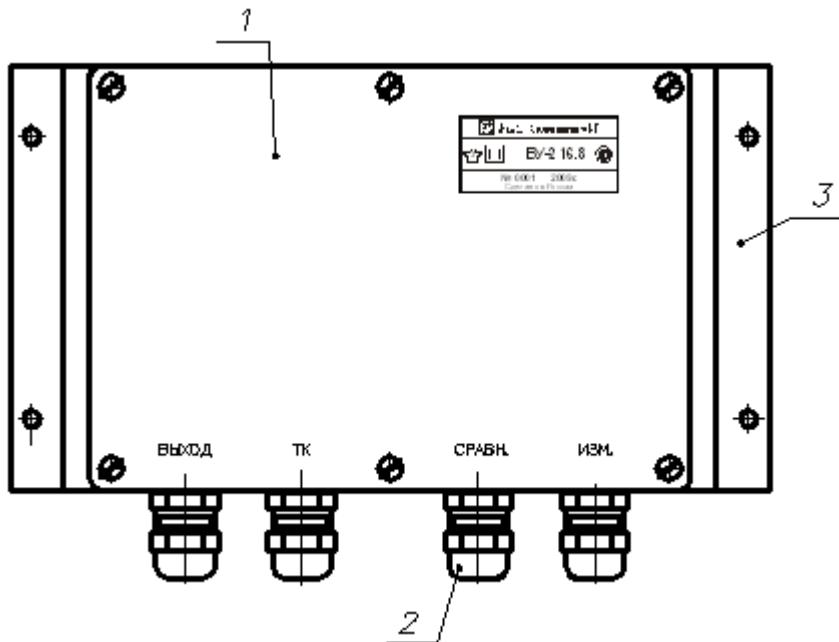

1. Корпус. 2. Гермоводы. 3. Скоба.

Рисунок 2 – Усилитель входной ВУ-216.4МИ

Вся информация о результатах и единицах измерения, другая вспомогательная информация отражается на табло, расположенном на лицевой панели преобразователя (рисунок 3).

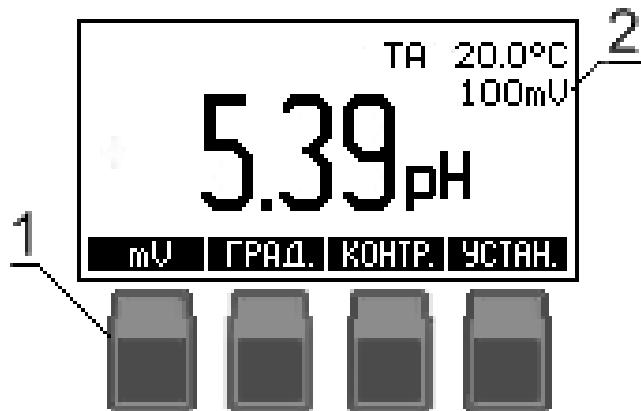


Рисунок 3 – Панель управления(1) и табло (2)

Панель управления преобразователем состоит из четырех кнопок 1 расположенных под табло 2 (рисунок 3).

Название и назначение кнопок изменяется в зависимости от режима работы преобразователя и отображается на нижней строке табло 2 над кнопками. В процессе настройки преобразователя может быть изменен (отредактирован) тот символ или цифра, которые выделены мигающим курсором.

Использование органов управления преобразователя в разных режимах работы подробно описывается в соответствующих разделах.

3 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

По общим требованиям безопасности преобразователи соответствуют классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

К работе с преобразователями допускается персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации, формуляр, действующие правила эксплуатации электроустановок.

Подключение входных и выходных соединительных линий должно производиться при отключенном напряжении питания. Во время профилактических работ и ремонта преобразователь П-216.3МИ (блок преобразования БП-216.4МИ) также должен быть отключен от сети.

В процессе эксплуатации необходимо следить за исправным состоянием входящих в состав преобразователя узлов и герметичностью узлов уплотнений.

Не допускается эксплуатация преобразователя при параметрах питающего напряжения не соответствующих 2.1 ГРБА.421221.003ФО.

Клемма заземления преобразователя, имеющая соответствующую маркировку, должна быть надежно заземлена. Защитное заземление должно соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.

4 ПОДГОТОВКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ К РАБОТЕ

Преобразователь, перед вводом в эксплуатацию, следует отградуировать согласно указаниям формуляра ГРБА.421221.003ФО.

4.1 Порядок установки


Преобразователь П-216.3МИ (блок преобразования БП-216.4МИ) устанавливается в помещении, защищенном от вибрации, прямых солнечных лучей, влаги и пыли.

Возле места установки преобразователя П-216.3МИ (блока преобразования БП-216.4МИ) не должно быть сильных источников электромагнитных полей и тепла, окружающий воздух не должен содержать паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Преобразователь П-216.3МИ (блок преобразования БП-216.4МИ) устанавливается на стене или щите, руководствуясь размерами, приведенными на рисунке 4. Усилитель входной ВУ-216.4МИ устанавливается, руководствуясь размерами, приведенными на рисунке 5.


Длина соединительных кабелей от преобразователя П-216.3МИ (усилителя входного ВУ-216.4МИ) до электродной системы должно быть не более 10 м.

Длина соединительных кабелей от блока преобразования БП-216.4МИ до усилителя входного ВУ-216.4МИ должна быть не более 1,5 км.

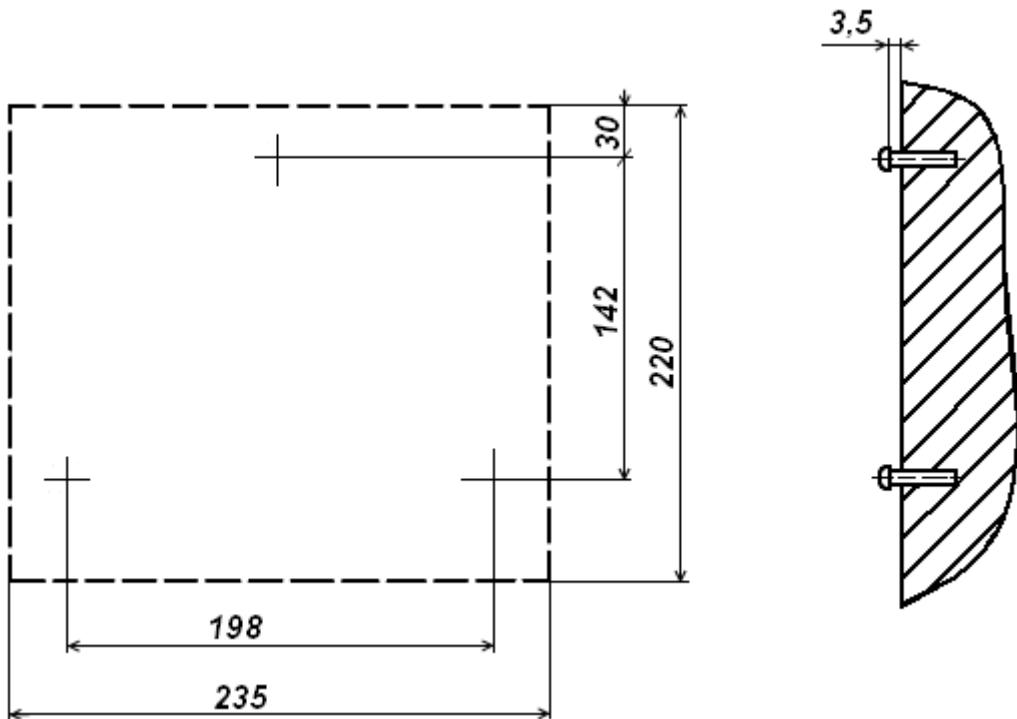

Для крепления использовать винты или шурупы диаметром 4 мм.
Размеры приведены в мм.

Рисунок 4 – Разметка крепления преобразователя

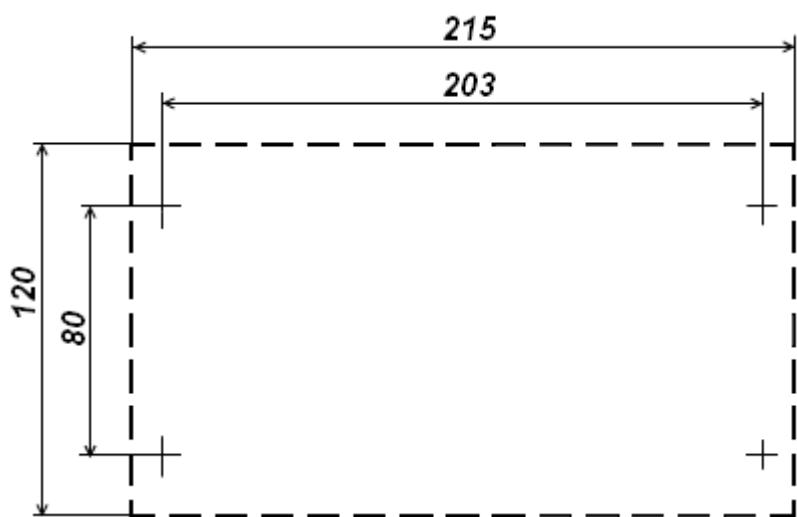

Для крепления использовать винты или шурупы диаметром 4 мм.
Размеры в мм.

Рисунок 5 – Разметка места установки ВУ-216.4МИ

4.2 Монтаж

Для использования преобразователя в составе анализатора жидкости следует выполнить соединение между преобразователем, электродной системой, термодатчиком (если он применяется), исполнительными и регистрирующими устройствами. Соединение следует выполнить в соответствии с приложениями А или Б.

Схема подключения также приведена на внутренней стороне крышки распределительной коробки преобразователя П-216.3МИ (блока преобразования БП-216.4МИ) и крышки усилителя входного ВУ-216.4МИ.



Во избежание попадания влаги внутрь корпуса и повреждения электронной схемы во время проведения монтажа, вскрытие корпуса и гермоводов преобразователя следует производить при относительной влажности не более 80%.



При подключении кабелей необходимо обеспечить герметичность их ввода в преобразователь (блок преобразования, входной усилитель). Для этого при установке кабелей в гермоводы следует пропустить их через резиновые уплотнители, установленные в гермоводах, и затянуть гайку.

4.2.1 Электродная система выбирается исходя из условий эксплуатации и особенностей контролируемой среды, и устанавливается в соответствующую арматуру. В качестве термодатчика может быть использован любой первичный измерительный преобразователь, выполненный на основе термопреобразователя сопротивления 100П/1,3850 по ГОСТ Р 8.625-2006 (например, ТДП-100). Установка электродной системы и термодатчика (если он применяется) должна производиться согласно указаниям документации на арматуру.

Электроды и термодатчик рекомендуется подсоединять к блоку преобразования (входному усилителю) через соединительную коробку, установленную вблизи от точки их установки или непосредственно на арматуре электродной системы. Длина кабелей электродов и термодатчика при этом не должна превышать 15 м.



Если термодатчик с преобразователем П-216.4МИ не используется, то следует установить перемычку 9-10 на колодке ВУ-216.4МИ (Приложение Б).

4.2.2 Электроды могут быть подсоединенены к блоку преобразования (входному усилителю) по недифференциальной и дифференциальной схеме включения (приложение Б).

Применение дифференциальной схемы включения рекомендуется при наличии значительных электрических помех, наводимых на электродную систему и при проведении измерений в средах, склонных к образованию осадков, вследствие чего сопротивление электрода сравнения в процессе эксплуатации может значительно увеличиваться.

4.2.3 Для подсоединения электродов к блоку преобразования (входному усилителю) следует использовать:

- при дифференциальной схеме подключения для цепей электродов рекомендуется использовать кабели типа КММ. Сопротивление изоляции цепей электродов после монтажа должно быть не менее 10^{12} Ом;

- при недифференциальной схеме включения для измерительного электрода - коаксиальный кабель (например, типа РК). Для электрода сравнения можно использовать любой кабель или провод с сечением жил не менее $0,35 \text{ мм}^2$ и сопротивлением изоляции не менее 10^7 Ом.

При использовании недифференциальной схемы включения электродной системы допускается подключение электродов и термодатчика непосредственно к блоку преобразования (входному усилителю).

4.2.4 Для подсоединения термодатчика к блоку преобразования (входному усилителю) можно использовать любой кабель или провод с сечением жил не менее $0,35 \text{ мм}^2$ и сопротивлением изоляции не менее 10^7 Ом . Сопротивление каждого из трех проводов линии термодатчика не должно превышать 10 Ом .

4.2.5 Для соединения блока преобразования, входного усилителя и подключения преобразователя к системе контроля и управления для передачи выходных сигналов можно использовать любой кабель или провода, уложенные в кабельные короба или желоба, с сечением жил не менее $0,1 \text{ мм}^2$ и сопротивлением изоляции не менее 10^7 Ом .

Сопротивление каждого провода соединительной линии между блоком преобразования П-216.4МИ и усилителем входным ВУ-216.4МИ не должно превышать 75 Ом .

4.2.6 При подключении питания и шины рабочего заземления преобразователя (блока преобразования) использовать 3-х жильный провод, сечением $0,75 \text{ мм}^2$, например, провод ПВС-3х0,75.



Преобразователи выпускаются в двух исполнениях по напряжению питания (36 и 220 В). При подключении линии питания следует убедиться, что преобразователь рассчитан на выбранное напряжение питания.

4.3 Подготовка к работе с персональным компьютером

Преобразователи могут работать с персональным компьютером (ПК). При этом преобразователь присоединяется к СОМ-порту или USB-порту ПК. Связь осуществляется при помощи последовательного интерфейса RS-232C.

Последовательный интерфейс RS-232C — это промышленный стандарт для последовательной двунаправленной асинхронной передачи данных. В микроконтроллерных системах это один из наиболее часто встречающихся интерфейсов.

Интерфейс обеспечивает соединение двух устройств, одно из которых называется DTE (Data Terminal Equipment) — ОД (Оконечное Оборудование Данных), второе — DCE (Data Communications Equipment) — ОПД (Оборудование Передачи Данных). В нашем случае DTE (ОД) — это компьютер, а DCE (ОПД) — это преобразователь.

В отличие от параллельного порта, состоящего из восьми информационных линий и за один такт передающего байт, порт RS-232C требует только одну такую линию, по которой последовательно передается бит за битом.

Спецификация RS-232C не ограничивают максимальную длину кабеля, но ограничивают максимальное значение его емкости величиной 2500 пФ. Емкость интерфейсных кабелей различна, однако общепринятой длиной считается длина 15 метров (до 20000 бод).

Диск, содержащий программу связи с ПК и инструкцию по установке и работе с программой, по требованию заказчика, может включаться в комплект преобразователя.

Кабель для соединения к ПК подключается к СОМ-порту розеткой DB-9F (female – «мама») (таблица 1).

В таблице 1 показано назначение контактов соединителя DB-9.

Таблица 1

Контакт	Направление передачи и название сигнала	
CD	1	< Carrier Detect (CD) Наличие несущей частоты
RD	2	< Received Data (RD) Принимаемые данные
TD	3	> Transmitted Data (TD) Передаваемые данные
DTR	4	> Data Terminal Ready (DTR) Готовность ООД
GND	5	- Signal Ground (GND) Общий
	6	< Data Set Ready (DSR) Готовность ОПД
	7	> Request To Send (RTS) Запрос на передачу
	8	< Clear To Send (CTS) Готов передавать
	9	< Ring Indicator (RI) Наличие сигнала вызова

Для передачи данных предназначены цепи RD и TD. Остальные цепи предназначены для индикации состояния устройств (DTR, DSR), управления передачей (RTS, CTS) и индикации состояния линии (CD, RI). Полный набор цепей используется только для подключения к ПК внешнего модема. В нашем случае используется только 3 цепи (RD, TD и GND) (Приложение А).

Для присоединения преобразователя к USB-порту ПК следует использовать стандартные переходники USB - RS-232 (рисунок 6) (в комплект поставки не входят). При этом кабель для соединения преобразователя к СОМ-порту подключается к переходнику.



Рисунок 6 - Переходники USB - RS-232

После подключения такого переходника и установки драйверов в ПК появляется виртуальный СОМ-порт, через который можно общаться с преобразователем. Номер этого виртуального СОМ-порта можно узнать, открыв диспетчер устройств ПК (строка «Порты (СОМ и LPT»)).

Программа «**Analytics**» позволяет считывать результаты измерений преобразователей, отображать их в виде таблицы или линейного графика.

5 РАБОТА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

5.1 Общие указания

Перед началом эксплуатации преобразователь необходимо включить в сеть и прогреть не менее 30 мин. Во время эксплуатации следует не реже одного раза в две недели производить градуировку рН-метра в составе преобразователя и чувствительного элемента согласно 5.4.

5.2 Режимы работы преобразователя

Преобразователь работает в следующих режимах:

- режим «ИЗМЕРЕНИЕ»;
- режим «ГРАДУИРОВКА»;
- режим «УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ»;
- режим «КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ».

Алгоритм управления преобразователями в зависимости от режима его работы отображен в приложении Г.

5.3 Режим «ИЗМЕРЕНИЕ»

Режим измерений является основным режимом работы преобразователя. В этом режиме преобразователь преобразует электрические сигналы первичных преобразователей (электродной системы и термодатчика) в показания на табло и выходные сигналы в соответствии с настройками.

Этот режим устанавливается сразу после включения преобразователя.

5.3.1 Переключение между режимами измерений pH и Eh (ЭДС) осуществляется нажатием кнопки **mV** или **pH**.

5.3.2 В режиме измерений pH на табло преобразователя отображаются измеренное значение pH анализируемого раствора и величина ЭДС применяемой электродной системы. Пример отображения информации на табло в режиме измерения pH приведен на рисунке 7.



Рисунок 7 - Пример отображения информации на табло
в режиме измерения pH

На табло индицируются: текущий результат измерения 1, включение функции приведения результата измерения pH к температуре 25 °C (если используется) 2, вид термокомпенсации 3, температура 4, текущий результат измерения потенциала электродной системы 5 и единицы измерения 6.



Для компенсации влияния температуры анализируемой среды на характеристики электродной системы, а также для осуществления приведения значения pH к 25 °C преобразователю необходима информация о температуре раствора.

Температура анализируемой среды может измеряться автоматически или устанавливаться вручную.

Ручную установку температуры рекомендуется использовать только при постоянной температуре анализируемой среды. Автоматическое измерение температуры возможно только в том случае, если к преобразователю подключен термодатчик.

При измерениях pH химически обессоленной воды и конденсата пара котлов высокого давления и турбин производственных вод тепловых электростанций, в преобразователе предусмотрено автоматическое приведение измеренного значения pH к температуре 25 °C (5.5.9).

Для того чтобы проводить измерения pH с нормируемой погрешностью необходимо преобразователь подготовить согласно разделу 4.3 и отградуировать преобразователь в комплекте анализатора согласно 5.4.

Выбор измерений pH или ЭДС производится нажатием кнопки pH/(mV).

5.3.3 В режиме измерения Eh или ЭДС электродной системы на табло преобразователя отображаются измеренное значение в мВ, температура раствора и вид термокомпенсации.

Пример отображения информации на табло в режиме измерения Eh или ЭДС электродной системы приведен на рисунке 8.

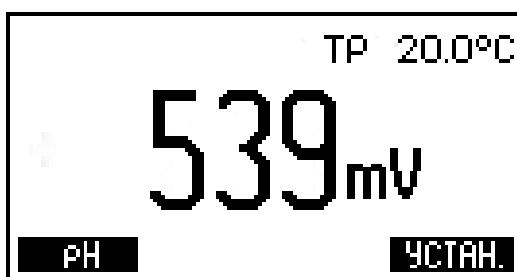


Рисунок 8 - Пример отображения информации на табло в режиме измерения Eh или ЭДС электродной системы



В случае появления на табло сообщения о перегрузке следует выполнить рекомендации раздела 7.

5.4 Режим «ГРАДУИРОВКА»

Режим «ГРАДУИРОВКА» предназначен для выполнения градуировки преобразователя в составе анализатора для измерений pH.

Градуировка это совокупность операций по доведению погрешности измерений комплекта pH-метра до нормируемых значений. Градуировка производится периодически, а также в следующих случаях:

- при замене и (или) перезарядке электродов;
- при получении преобразователя из ремонта или после длительного хранения;
- при возникновении сомнений в достоверности результатов измерений.

5.4.1 Градуировочные растворы

Градуировка комплекта pH-метра должна производиться по градуировочным растворам, в качестве которых рекомендуется применять рабочие эталоны pH по ГОСТ 8.135-2004 со значениями pH_{25}° : 1,65, 4,01, 6,86, 9,18, 12,43. Температурная зависимость значений pH этих растворов (приложение В) заложена в память преобразователя. Поэтому при использовании указанных растворов преобразователь в процессе градуировки автоматически определяет выбранный раствор и выводит его значение на табло. Это позволяет упростить и ускорить процесс проведения градуировки.

Рабочие эталоны для «рН-метрии» выпускаются в виде стандарт-титров. Методика их приготовления приведена на упаковке.

Допускается применение градуировочных растворов с другими значениями pH. Однако в этом случае пользователю придется вводить их значения pH вручную.

При выборе градуировочных растворов рекомендуется придерживаться такого принципа, чтобы их значения pH охватывали диапазон pH анализируемых растворов. Разница в значениях pH у градуировочных растворов должна быть не менее единицы. Температура градуировочных растворов должна быть одинаковой ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) и постоянной.

Для снижения погрешности измерений рекомендуется градуировку осуществлять при температуре близкой к температуре анализируемых растворов.

Не следует производить градуировку по растворам, приготовленным из случайных реагентов неизвестной квалификации, так как при этом возможны значительные ошибки в значении pH приготовленных растворов. Следует иметь в виду, что при многократном использовании одной и той же порции раствора может произойти изменение его pH за счет внесения случайных примесей. Поэтому не рекомендуется повторное использование растворов при градуировке.

5.4.2 Варианты градуировки

В зависимости от условий последующих измерений и требуемой их точности преобразователь может быть отградуирован по одному или двум градуировочным растворам.

Градуировка по одному раствору не позволяет обеспечить высокую точность измерений в широком диапазоне pH и поэтому может применяться только для работы в узкой области (не более ± 1 от значения pH, использованного градуировочного раствора).



Возможна градуировка преобразователя по анализируемому раствору, если известно его текущее значение pH с достаточной точностью (например, по результатам лабораторного анализа). Для этого электродная система из анализируемой среды не извлекается и при градуировке устанавливается значение pH раствора, так, как описано в п. 5.4.4.

Градуировка по двум растворам это наиболее часто применяемый и рекомендуемый вариант градуировки. Она обеспечивает получение результатов измерений с нормируемой погрешностью и может применяться для большинства анализов.



В случаях, не требующих высокой точности измерений, допускается вместо проведения градуировки ограничиться вводом паспортных значений pH_i и E_i (по 5.5.7). После чего следует перейти в режим измерений без проведения градуировки.

Ориентировочное значение погрешности последующих измерений в этом случае составит ~0,3 pH.

5.4.3 Подготовка к градуировке


Перед началом градуировки рекомендуется убедиться в том, что установленные в преобразователе значения координат изопотенциальной точки соответствуют паспортным значениям применяемой электродной системы. Для этого следует выполнить операции по 5.6 и, при необходимости, операции по 5.5.8.



При градуировке и в процессе измерения рекомендуется использовать один и тот же вид термокомпенсации.

5.4.4 Градуировка по одному раствору

Кнопкой pH/(mV) выбрать режим измерений pH. Нажать кнопку **ГРАД**.

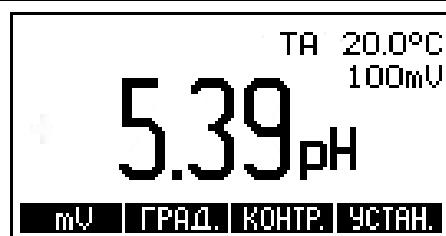

Во избежание потери градуировочных характеристик, введенных в память преобразователя, не рекомендуется без необходимости входить в режим «ГРАДУИРОВКА».

* Здесь и далее на рисунках, поясняющих порядок работы с преобразователем, приведены случайные показания на табло, в реальных условиях они могут быть иными.

Извлечь электродную систему (и термодатчик) из анализируемой среды, промыть их дистиллированной водой, осушить фильтровальной бумагой, поместить их в первый градуировочный раствор и нажать кнопку **ВВОД**.

ПОМЕСТИТЕ ЭЛЕКТРОДЫ
В ПЕРВЫЙ РАСТВОР
И НАЖМИТЕ ВВОД

ЗАКОНЧИТЬ

ВВОД



При использовании ручной термокомпенсации (ТР) преобразователь предложит ввести текущую температуру раствора вручную.

На табло преобразователя отображается ранее установленная температура раствора. Младший разряд мигает, указывая на возможность редактирования. Измерить термометром температуру раствора и, при необходимости, установить ее значение на табло кнопками **←**, **▲** и **▼**. Процедура редактирования подробно описана в 5.5.3. Нажать кнопку **ВВОД**. При этом установленное значение температуры будет занесено в память преобразователя.



При использовании автоматической термокомпенсации (ТА) операции по вводу значения температуры пропускаются.

Преобразователь переходит к измерению ЭДС электродной системы. На табло отображаются измеряемые значения ЭДС электродной системы и температуры раствора. После установления стабильных показаний температуры и ЭДС, следует нажать кнопку **ВВОД**.



Градуировка по одному раствору может быть прервана нажатием кнопки ЗАКОНЧИТЬ. В этом случае результаты градуировки в памяти преобразователя не сохраняются. В случае необходимости можно вернуться на предыдущий этап градуировки при помощи кнопки ←.

На основании полученных данных преобразователь автоматически определит ближайший, соответствующий этим данным раствор из перечня рабочих эталонов (приложение В) и выведет на табло значение его pH для температуры 25 °C. Если преобразователь правильно определил используемый раствор, нажать кнопку **ВВОД**.






Если при использовании одного из указанных растворов преобразователь его неправильно определил, то это свидетельствует об ошибке или неисправности. В этом случае градуировку рекомендуется прервать, и продолжить ее только после устранения причины неполадки (поз. 7 таблица 1).



Для удобства работы на табло преобразователя выводится pH рабочего эталона для 25 °C (значение, указанное на упаковке стандарт-титра). При расчете градуировочных характеристик преобразователь автоматически внесет поправку на текущую температуру раствора. Поэтому при использовании рабочих эталонов с pH_{25°}: 1,65, 4,01, 6,86, 9,18, 12,43 по ГОСТ 8.135-2004, не следует вносить эту поправку вручную.

Если в качестве градуировочного раствора применяется другой раствор, то значение его pH следует ввести при помощи кнопок **◀ ▶ ▲ ▼**. Редактирование производится аналогично процедуре описанной в 5.5.3. При этом следует вводить значение pH градуировочного раствора с учетом его текущей температуры, которая индицируется на табло преобразователя. После завершения редактирования нажать кнопку **ВВОД**.

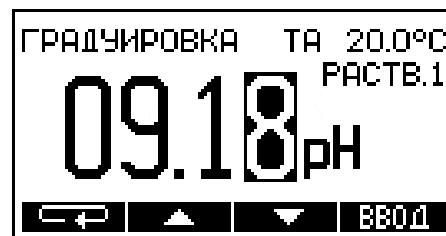

Преобразователь предлагает провести градуировку по второму раствору.

ПОМЕСТИТЕ ЭЛЕКТРОДЫ
ВО ВТОРОЙ РАСТВОР
И НАЖМИТЕ ВВОД

ЗАКОНЧИТЬ **ВВОД**



Если для последующих измерений достаточно градуировки по одному раствору, на этом этапе она может быть завершена. Для этого следует нажать кнопку ЗАКОНЧИТЬ.

5.4.5 Градуировка по двум растворам

Для продолжения градуировки промыть электродную систему и термодатчик (термометр) дистиллированной водой, осушить фильтровальной бумагой и поместить их во второй градуировочный раствор. Нажать кнопку **ВВОД**.

ПОМЕСТИТЕ ЭЛЕКТРОДЫ
ВО ВТОРОЙ РАСТВОР
И НАЖМИТЕ ВВОД

ЗАКОНЧИТЬ **ВВОД**



Температура второго градуировочного раствора не должна отличаться от температуры первого более чем на ±2 °C.

Преобразователь переходит к измерению ЭДС электродной системы. На табло преобразователя отображается измеряемые значения ЭДС электродной системы и температуры раствора. После установления стабильных показаний температуры и ЭДС электродной системы, следует нажать кнопку **ВВОД**.



i Градуировка по второму раствору может быть прервана нажатием кнопки **ЗАКОНЧИТЬ**. В этом случае в памяти преобразователя сохраняются результаты градуировки по одному раствору.

В случае необходимости можно вернуться на предыдущий этап градуировки при помощи кнопки **←**.



На этом этапе возможен вывод сообщения об ошибке (поз. 8 таблица 1).

На основании полученных данных преобразователь автоматически определит ближайший, соответствующий этим данным раствор из перечня рабочих эталонов (приложение В) и выведет на табло значение его pH для температуры 25 °C. Если преобразователь правильно определил используемый раствор, нажать кнопку **ВВОД**.



Для удобства работы на табло преобразователя выводится pH рабочего эталона для 25 °C (значение, указанное на упаковке стандарт – титра). При расчете градуировочных характеристик преобразователь автоматически внесет поправку на текущую температуру раствора. Поэтому при использовании рабочих эталонов с pH₂₅₀: 1,65, 4,01, 6,86, 9,18, 12,43 по ГОСТ 8.135-2004, не следует вносить эту поправку вручную.



Если при использовании одного из указанных рабочих эталонов преобразователь его неправильно определил, то это свидетельствует об ошибке или неисправности. В этом случае градуировку рекомендуется прервать, и продолжить ее только после устранения причины неполадки (поз. 7 таблица 1).

Если в качестве градуировочного применяется другой раствор, то значение его pH следует ввести при помощи кнопок **←**, **↑**, **↓**. Редактирование производится аналогично процедуре описанной в 5.5.3. При этом следует вводить значение pH градуировочного раствора с учетом его текущей температуры, которая индицируется на табло преобразователя. После завершения редактирования нажать кнопку **ВВОД**.





На этом этапе возможен вывод сообщения об ошибке (поз. 9-10 таблица 1).

Преобразователь автоматически перейдет в режим «ИЗМЕРЕНИЕ».

5.4.6 Контроль правильности проведения градуировки

Проверка правильности проведения градуировки производится в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ».

Промыть электродную систему и термодатчик (термометр) дистиллированной водой, осушить фильтровальной бумагой и погрузить их в раствор с известным значением pH.

При использовании ручной термокомпенсации (TP) ввести температуру раствора вручную (5.5.3). После установления стабильных показаний считать результат измерения с табло.

Если погрешность измерений превышает 0,05 pH, следует проверить градуировочные растворы и провести повторную градуировку.

5.5 Режим «УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ»

5.5.1 Данный режим предназначен для:

- выбора вида термокомпенсации (ручная ТР или автоматическая ТА);
- ввода значения температуры анализируемой среды (при ручной термокомпенсации);
- настройки аналогового выходного сигнала (нижний предел и ширина поддиапазона);
- настройки фильтра аналогового выходного сигнала;
- настройки релейного выхода;
- ввода значений координат изопотенциальной точки электродной системы pH_i и E_i;
- установки функций приведения pH к температуре 25°C.

Для выбора режима «УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ» следует нажать кнопку **УСТАН**. После перехода кнопками ▲ и ▼ нужно выбрать параметры, подлежащие корректировке.

5.5.2 Выбор вида термокомпенсации

Для выбора вида термокомпенсации следует нажать кнопку **УСТАН**.



В меню установок параметров кнопками ▲ и ▼ выбрать «УСТАНОВКА ТЕРМОКОМП.». Нажать кнопку **РЕДАК**.





Для перехода в режим измерения из режима установки без проведения редактирования параметров следует нажать кнопку ВЫХОД.

Кнопками ▲ и ▼ выбрать необходимый вид термокомпенсации: ручную - «ТР» или автоматическую - «ТА». Нажать кнопку ВВОД.

УСТАНОВКА ТЕРМОКОМП.

ТР



Автоматическое измерение температуры (ТА) возможно только в том случае, если к преобразователю подключен термодатчик.




Если выбрана ручная термокомпенсация («ТР») преобразователь автоматически перейдет к ручной установке температуры (5.5.3).

5.5.3 Ручная установка температуры



Ручная установка температуры возможна только при выборе ручной термокомпенсации (ТР).

Для ручной установки температуры раствора следует нажать кнопку УСТАН.

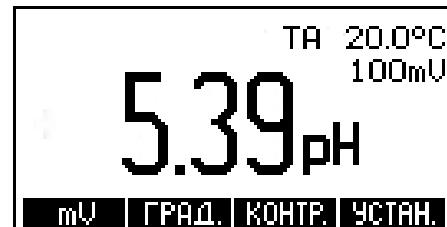

В меню установок параметров кнопками ▲ и ▼ выбрать «УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ».

Нажать кнопку РЕДАК.



На табло выводится значение температуры раствора, установленное ранее. Младший разряд мигает, показывая, что он может быть изменен. Выбор разряда числа или знака осуществляется последовательным нажатием кнопки **РЕДАК**. Изменять можно ту цифру или знак, который мигает в данный момент на табло. Увеличение или уменьшение и изменение знака (+/-) производится соответствующими кнопками ▲ или ▼. Для завершения редактирования следует нажать кнопку ВВОД. При этом гаснут незначащие нули и знак «+».



5.5.4 Настройка токового выхода



При эксплуатации преобразователя в системах автоматического контроля и регулирования, использующих аналоговые выходные сигналы преобразователя, необходимо установить значения верхнего и нижнего пределов поддиапазона измерения, соответствующие минимальному и максимальному значениям выходного сигнала.

Для установки поддиапазона преобразователя, соответствующего нормирующими значениям выходных сигналов следует нажать кнопку **УСТАН.**



В меню установок параметров кнопками **▲** и **▼** выбрать «**УСТАНОВКА ДИАПАЗОНА**».

При этом на табло выводятся значения нижнего и верхнего пределов поддиапазона, установленные ранее. Нажать кнопку **РЕДАК.**



Используя кнопки **СП**, **▲** и **▼** отредактировать значение нижнего предела поддиапазона. Редактирование производится аналогично процедуре описанной в 5.5.3. Нажать кнопку **ВВОД**.



Нижний предел поддиапазона может быть установлен в пределах: от минус 2,00 pH (минус 3000 мВ) до 20,00 pH (2000 мВ) с дискретностью 0,01 pH (1 мВ).



При установке поддиапазона преобразователя автоматически выбираются те единицы измерения, которые были установлены на момент входа в режим редактирования.

Кнопками **▲** и **▼** нужно выбрать значение конца поддиапазона. Установка осуществляется дискретно с шагом, соответствующим допустимым значениям ширины поддиапазона, которые выбираются из ряда: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 5,0; 10,0; 15,0 pH (100; 150; 200; 250; 500; 1000; 1500; 2000 мВ) в пределах диапазона измерений преобразователя. Нажать кнопку **ВВОД**.




Значение pH или мВ, соответствующее максимальному значению выходного тока может быть как больше, так и меньше значения, соответствующего минимальному значению выходного тока.

5.5.5 Настройка фильтра аналогового выходного сигнала




Для предотвращения срабатывания исполнительных устройств в системах автоматического контроля и управления в результате случайных кратковременных скачков измеряемых величин в преобразователях предусмотрен низкочастотный цифровой фильтр аналогового выходного сигнала с регулируемой постоянной времени.

Для перехода к меню установки параметров следует нажать кнопку **УСТАН.**

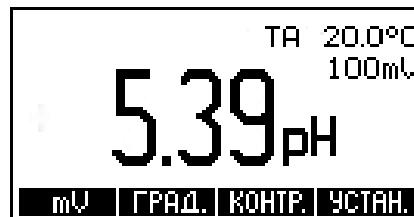

В меню установок параметров кнопками **▲** и **▼** выбрать «**УСТАНОВКА УСРЕДНЕНИЯ**». На табло отображается значение постоянной времени фильтра выходного тока преобразователя. Нажать кнопку **РЕДАК.**

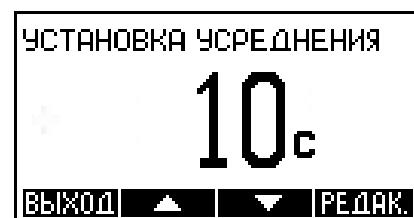

Используя кнопки **◀ ▶**, **▲** и **▼** отредактировать значение постоянной времени. Редактирование производится аналогично процедуре описанной в 5.6.3. Нажать кнопку **ВВОД**.



Постоянная времени фильтра аналогового выходного сигнала преобразователя может быть задана в диапазоне 0 до 120 секунд. При установке значения этого параметра, равного нулю, усреднение значения выходного тока не производится.

5.5.6 Настройка релейного выхода



При снижении (превышении) значений pH (мВ) анализируемого раствора ниже (выше) установленных в преобразователе пределов срабатывает автоматическое управление технологическим процессом. При этом заются контакты реле K2 (K1) (приложения А, Б) и на лицевой панели зажигается индикатор K2 (K1). Если в течение 30 с значение pH не войдет в установленные пределы срабатывает автоматическая сигнализация. При этом выдается звуковой сигнал и индикатор K2 (K1) начинает мигать.

Для установки пределов сигнализации при измерении pH следует нажать кнопку **УСТАН.**



В меню установок параметров кнопками ▲ и ▼ нужно выбрать «УСТАНОВКА ПРЕДЕЛОВ». При этом на табло выводится значение пределов срабатывания сигнализации, установленные ранее. Нажать кнопку РЕДАК.

УСТАНОВКА ПРЕДЕЛОВ	
ПРЕДЕЛ1	4.00 рН
ПРЕДЕЛ2	8.00 рН
ВЫХОД	РЕДАК.

Используя кнопки , ▲ и ▼ следует установить минимальное значение рН, ниже которого срабатывает сигнализация. Нажать кнопку ВВОД.

УСТАНОВКА ПРЕДЕЛОВ	
ПРЕДЕЛ1	08.00 рН
ВВОД	ВВОД

Аналогично установить рН, выше которого срабатывает сигнализация. Нажать кнопку ВВОД.

УСТАНОВКА ПРЕДЕЛОВ	
ПРЕДЕЛ2	10.00 рН
ВВОД	ВВОД



При установке нужно учитывать, что значение нижнего предела должно быть меньше верхнего.

5.5.7 Редактирование значений координат изопотенциальной точки



Для правильной работы термокомпенсации необходимо, чтобы координаты изопотенциальной точки, введенные в память преобразователя, соответствовали значениям применяемой электродной системы. Значения координат изопотенциальной точки pH_i и E_i указываются в паспортах на электроды.

Для редактирования значений координат изопотенциальной точки измерительного электрода следует нажать кнопку УСТАН.

ТА 20.0°C	100mV		
5.39	рН		
mV	ГРАД.	КОНТР.	УСТАН.

В меню установок параметров кнопками ▲ и ▼ выбрать «УСТАНОВКА pH_i и E_i ». При этом на табло выводятся значения pH_i и E_i , установленные ранее. Нажать кнопку РЕДАК.

УСТАНОВКА pH_i и E_i	
pH_i	= 7.00
E_i	= -25 mV
ВЫХОД	РЕДАК.

Используя кнопки , ▲ и ▼ установить значение pH_i . Нажать кнопку ВВОД.


УСТАНОВКА pH_i	
+ 07.00	рН
ВВОД	ВВОД

Аналогично установить значение E_i . Нажать кнопку **ВВОД**.



*В случае использования измерительного электрода, не имеющего нормированных координат изопотенциальной точки (например – сурьмяного электрода), при редактировании знака значения pX_i кнопками Δ , ∇ следует установить на табло мигающий знак «НЕТ» и нажать кнопку **ВВОД**. После этого преобразователь автоматически переходит в режим градуировки.*

5.5.8 Включение или выключение функции приведения измеренного значения pH к заданной температуре



В некоторых случаях, например, при контроле водно-химического режима тепловых электростанций требуется получить значение pH, приведенное к температуре 25 °C.

В преобразователе предусмотрена возможность приведения измеренного значения pH к температуре 25 °C для следующих анализируемых сред:

- питательная вода прямоточных котлов (по РД 34.37.308-90 - функция П1);
- pH-нейтральная вода (функция П2).

Для включения и выбора функции приведения следует нажать кнопку **УСТАН**.



В меню установок параметров кнопками Δ и ∇ выбрать «**ПРИВЕДЕНИЕ**». При этом на табло отображается: включена или выключена функция приведения, вид приведения (П1 или П2) и температура, к которой приводится значение pH. Для изменения параметров нажать кнопку **РЕДАК**.


Используя кнопки Δ и ∇ установить «**ВКЛ**» или «**ВЫКЛ**».

Нажать кнопку **ВВОД**. При выборе «**ВЫКЛ.**» преобразователь автоматически перейдет в режим «**ИЗМЕРЕНИЕ**», при этом измеренное значение pH не будет приводится к температуре 25 °C.



В случае, если функция приведения включена следует, используя кнопки, \blacktriangle и \blacktriangledown , установить вид (метод) приведения (П1 или П2). Нажать кнопку **ВВОД**.

Преобразователь автоматически перейдет в режим «**ИЗМЕРЕНИЕ**», при этом измеренное значение pH будет приведено к температуре 25 °C.

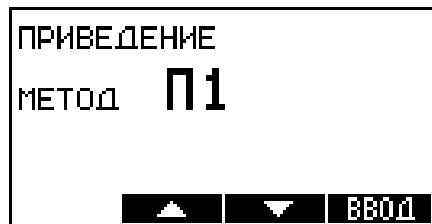


5.6 Режим «КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ»


Режим «**КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ**» предназначен для просмотра параметров, сохраненных в памяти преобразователя:

- значений координат изопотенциальной точки;
- значения крутизны электродной характеристики;
- значений pH использовавшихся при градуировке растворов и их температуры.

Для выбора режима «**КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ**» следует нажать кнопку **КОНТР**.

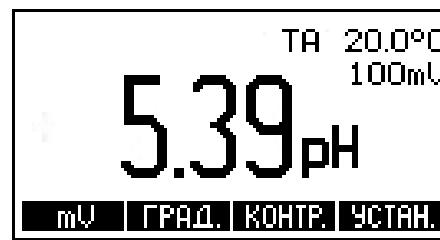

Для просмотра значений параметров, полученных при предыдущей градуировке, используются кнопки \blacktriangle и \blacktriangledown . Выход в режим измерения производится после нажатия кнопки **ЗАКОНЧИТЬ**.

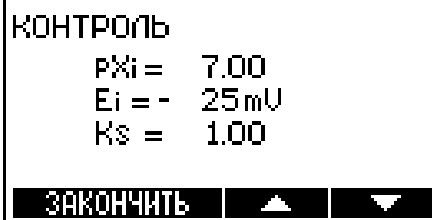

В случае использования измерительного электрода, не имеющего нормированных координат изопотенциальной точки (например – сурьмянного электрода), их значения при просмотре параметров не выводятся.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Градуировку и проверку преобразователей следует проводить в следующих случаях:

- после ремонта или длительного хранения;
- при поверке и периодическом контроле основных характеристик преобразователя, если выясняется их несоответствие нормирующими значениям.

7 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Сразу после включения преобразователь проводит самотестирование. При обнаружении неисправности преобразователя или электродной системы, а также, если в процессе градуировки были допущены ошибки, преобразователь выводит на табло сообщение об ошибке.

Внешнее проявление ошибок, вероятная причина и методы их устранения перечислены в таблице 2.

Если неисправность самостоятельно устранить не удается необходимо обратиться на предприятие производящее ремонт.

Таблица 2

Внешнее проявление и признаки неисправности, сообщение на табло 1	Характер неисправности 2	Вероятная причина 3	Метод устранения 4
Неисправности и ошибки, возникающие при измерениях			
1 При включении тумблера «Сеть» на табло нет индикации.	Нет питания.	Обрыв в сетевом проводе.	Проверить и отремонтировать сетевой провод.
2 На табло сообщение: «ПЕРЕГРУЗКА ПО ВХОДУ», звуковой сигнал.	Напряжение на входе преобразователя выходит за пределы диапазона (минус 3000...2000) мВ.	Обрыв в цепях электродов. Электроды не погружены в раствор. Воздушные пузыри в электроде сравнения или нарушено истечения электролита из него.	Устранить обрыв. Погрузить электроды в раствор. Удалить пузыри. Прочистить электролитический ключ, промыть его в горячей воде и залить KCl.
3 На табло мигает символ «°C».	Недопустимая температура анализируемого раствора (только для электродов, не имеющих нормированных координат изопотенциальной точки).	Температура анализируемого раствора отличается от температуры градуировочных растворов более чем на 2,0 °C.	Привести в соответствие температуру анализируемого раствора или выполнить градуировку преобразователя для требуемой температуры.

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
4 На табло сообщение: « ПЕРЕГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТА pH », звуковой сигнал.	Полученное в результате расчетов значение pH выходит за пределы диапазона (минус 2...16) pH.	Обрыв в цепи электродов. Электроды не погружены в раствор. Воздушные пузыри в электроде сравнения или нарушение истечения электролита из него. Градуировка проведена неверно.	Устранить обрыв. Погрузить электроды в раствор. Удалить пузыри. Прочистить электролитический ключ, промыть его в горячей воде и залить KCl. Провести повторную градуировку.
5 На табло сообщение: « ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ », звуковой сигнал.	Недопустимое сопротивление термодатчика.	Обрыв или замыкание в цепи термодатчика. Неисправность термодатчика. Установленный термодатчик имеет НСХ отличную от Pt100.	Устранить обрыв или замыкание. Заменить термодатчик.
6 Показания преобразователя неустойчивы.	Недопустимо высокое электрическое сопротивление электродных цепей.	Обрыв или плохой контакт в цепях электродов. Электроды не полностью погружены в раствор. Воздушные пузыри в электроде сравнения или нарушено истечение электролита из него.	Проверить соединительные кабели и надежность контактов. Устранить причину. Погрузить электроды в раствор. Удалить пузыри. Прочистить электролитический ключ, промыть его в горячей воде и залить KCl.
	Влияние электромагнитных помех.	Нет надежного заземления преобразователя.	Проверить провода заземления, зачистить их в месте присоединения к зажиму заземления.
	Неверное включение преобразователя.	Без использования термодатчика не установлена перемычка 9-10 на колодке ВУ-216.4МИ.	Установить перемычку.
7 Показания преобразователя не изменяются при изменении pH (Eh) анализируемой среды.	-	Выход из строя или повреждение измерительного электрода. Замыкание в цепях электродов.	Заменить электрод. Проверить соединительные кабели и устранить причину.

Окончание таблицы 2

1	2	3	4
Неисправности и ошибки, выявляемые при градуировке			
8 Преобразователь неправильно определяет используемый при градуировке раствор из перечня рабочих эталонов с pH_{25} : 1,65, 4,01, 6,86, 9,18, по ГОСТ 8.135-2004	-	Ошибка при приготовлении градуировочного раствора.	Приготовить новый раствор и повторить градуировку.
		Введенные в преобразователь координаты изопотенциальной точки не соответствуют паспортным значениям применяемой электродной системы.	Ввести правильные координаты изопотенциальной точки (5.5.7). Повторить градуировку.
		Электрод выработал свой ресурс или неисправен.	Заменить электрод и повторить градуировку.
9 На табло сообщение: « ЗНАЧЕНИЕ pH1=pH2 ». Через 4-6 секунд сообщение гасится, и преобразователь предлагает повторить градуировку по первому раствору.	Разница между значениями ЭДС электродной системы, измеренными в первом и втором градуировочном растворе, недопустимо мала	Ошибка при приготовлении растворов или использование при градуировке одного и того же раствора.	Исправить ошибку и повторить градуировку.
		Использование для градуировки растворов, различающихся менее чем на 1pH.	
		Повреждена рабочая мембрана измерительного электрода.	Заменить электрод и повторить градуировку.
10 На табло сообщение: « ЗНАЧЕНИЕ pH1=pH2 ». Через 4-6 секунд сообщение гасится, и преобразователь предлагает повторить ввод значения pH второго градуировочного раствора.	Ввод значения pH второго градуировочного раствора, отличающегося от pH первого, менее чем на единицу.	Ввод неверного значения.	Исправить ошибку.
11 На табло сообщение: « ВНИМАНИЕ! НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ Ks ». Через 4-6 секунд сообщение гасится, и преобразователь предлагает повторить градуировку по первому раствору.		Ошибка при приготовлении градуировочных растворов.	Исправить ошибку и повторить градуировку.
		Электрод выработал свой ресурс или неисправен.	Заменить электрод и повторить градуировку.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схемы электрических соединений преобразователя П-216.3МИ

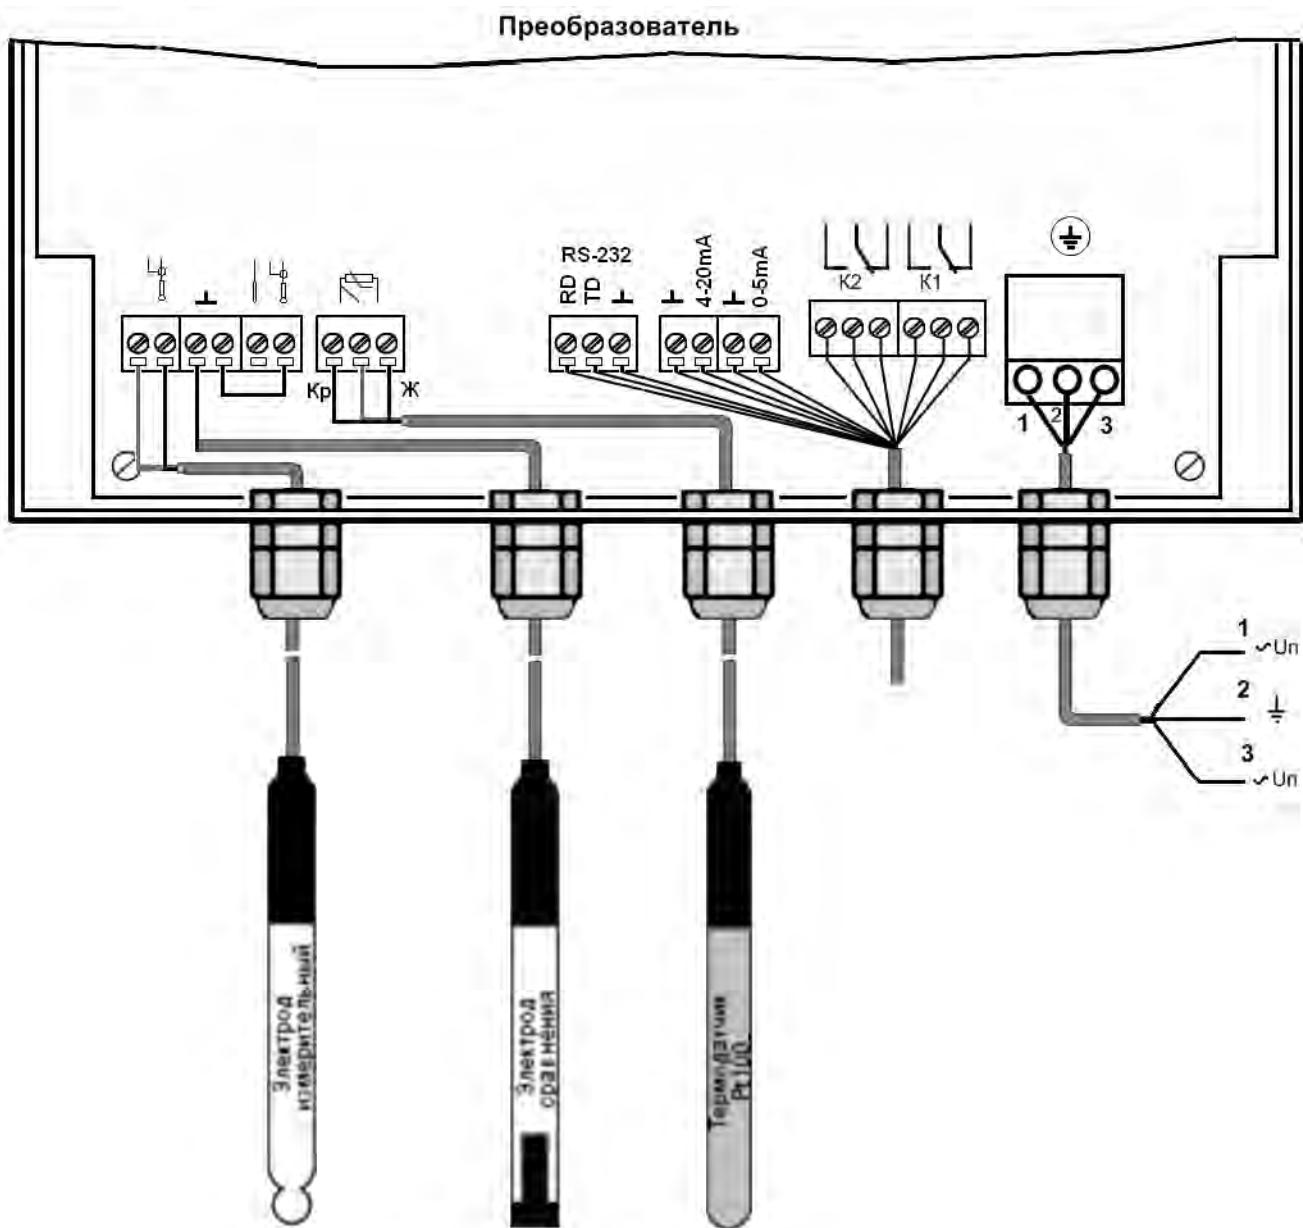


Рисунок А.1 – Недифференциальная схема включения

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

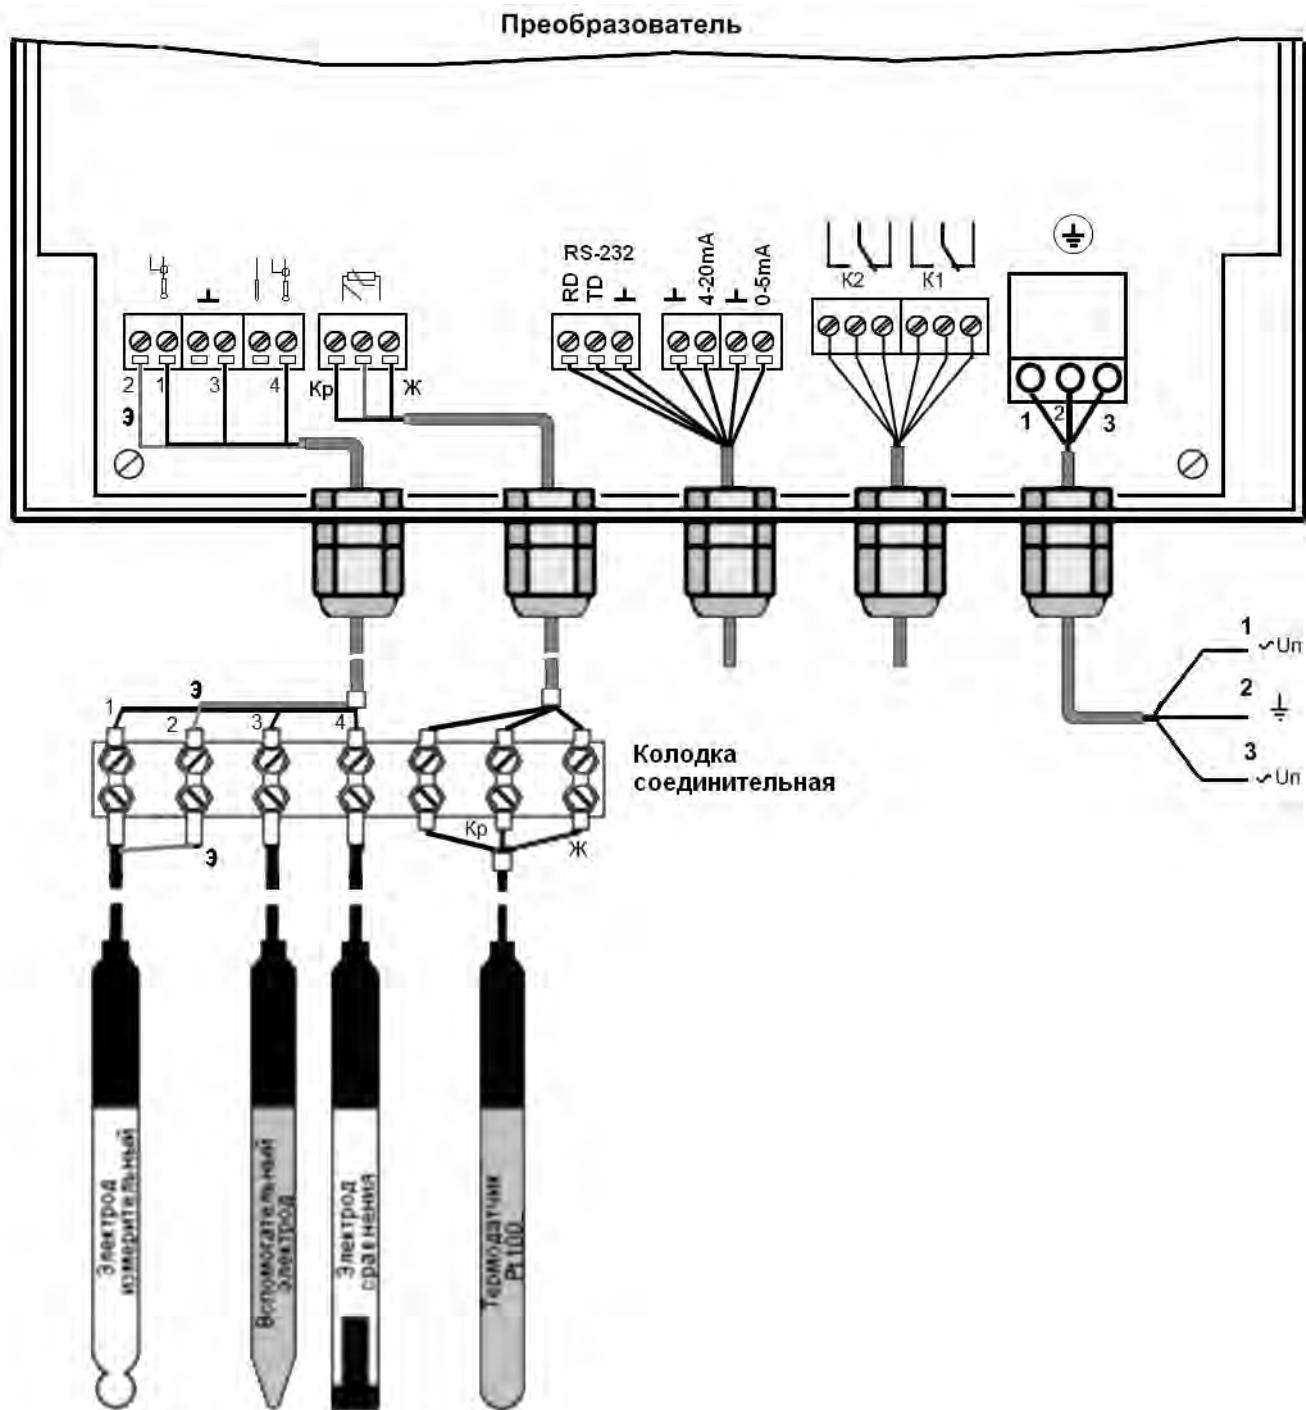


Рисунок А.2 – Дифференциальная схема включения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схемы электрических соединений преобразователя П-216.4МИ

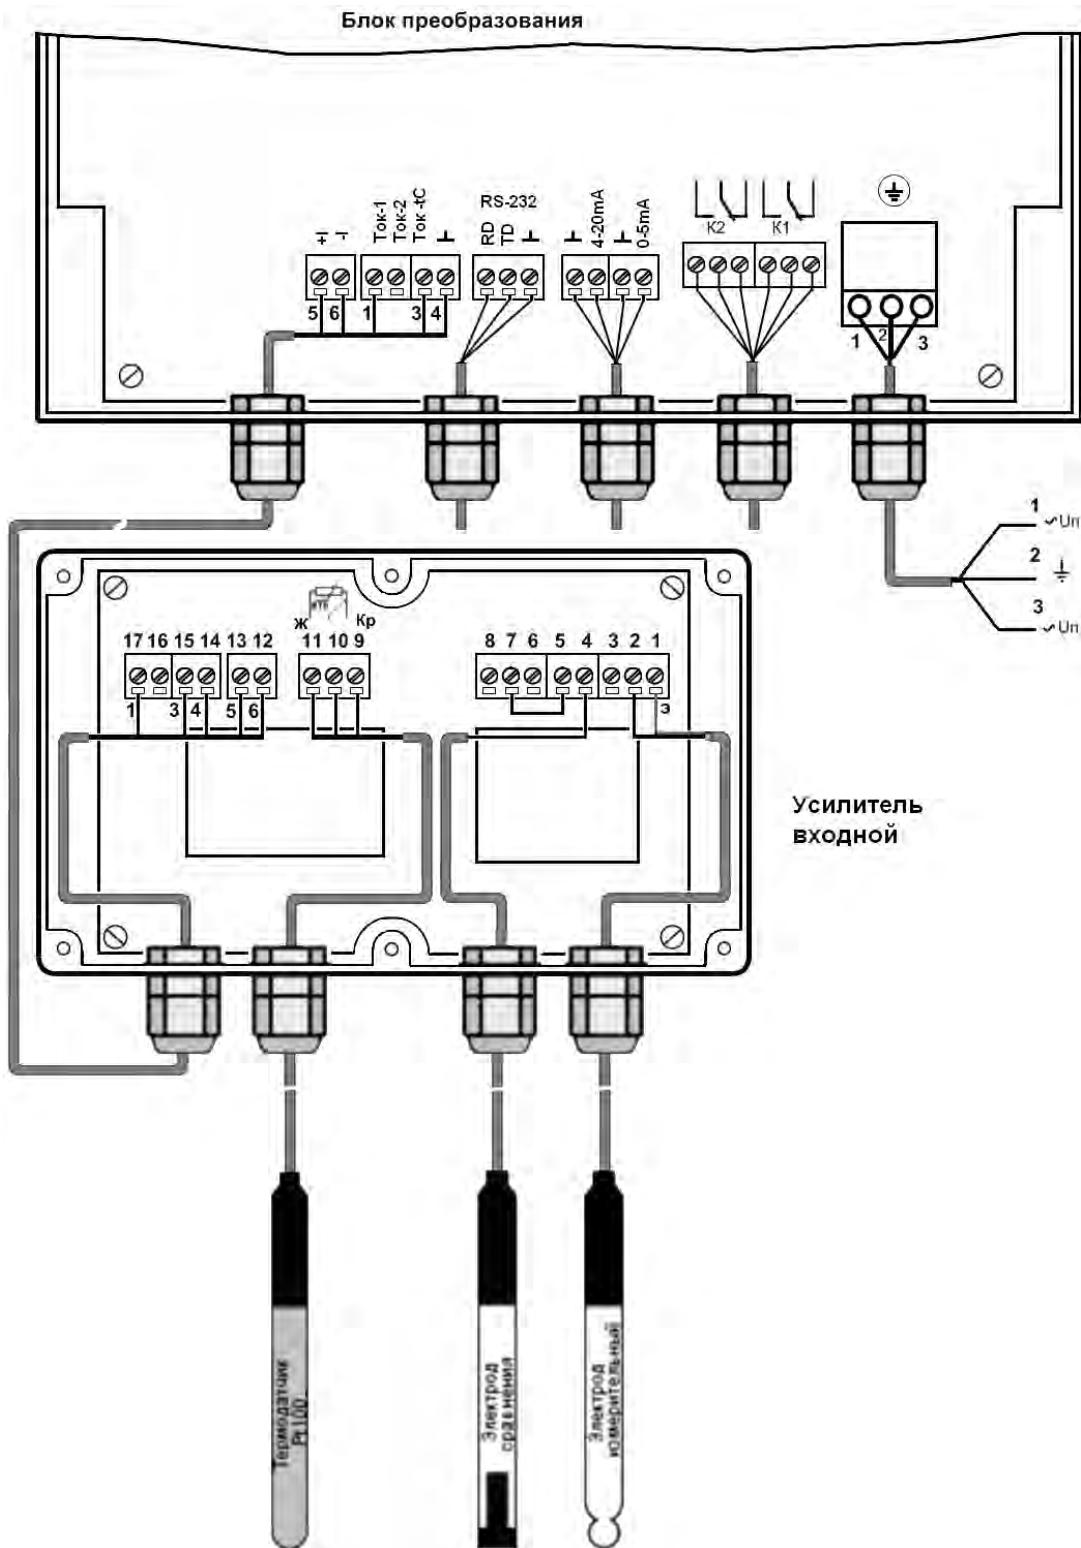


Рисунок Б.1 – Недифференциальная схема включения с применением термодатчика

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

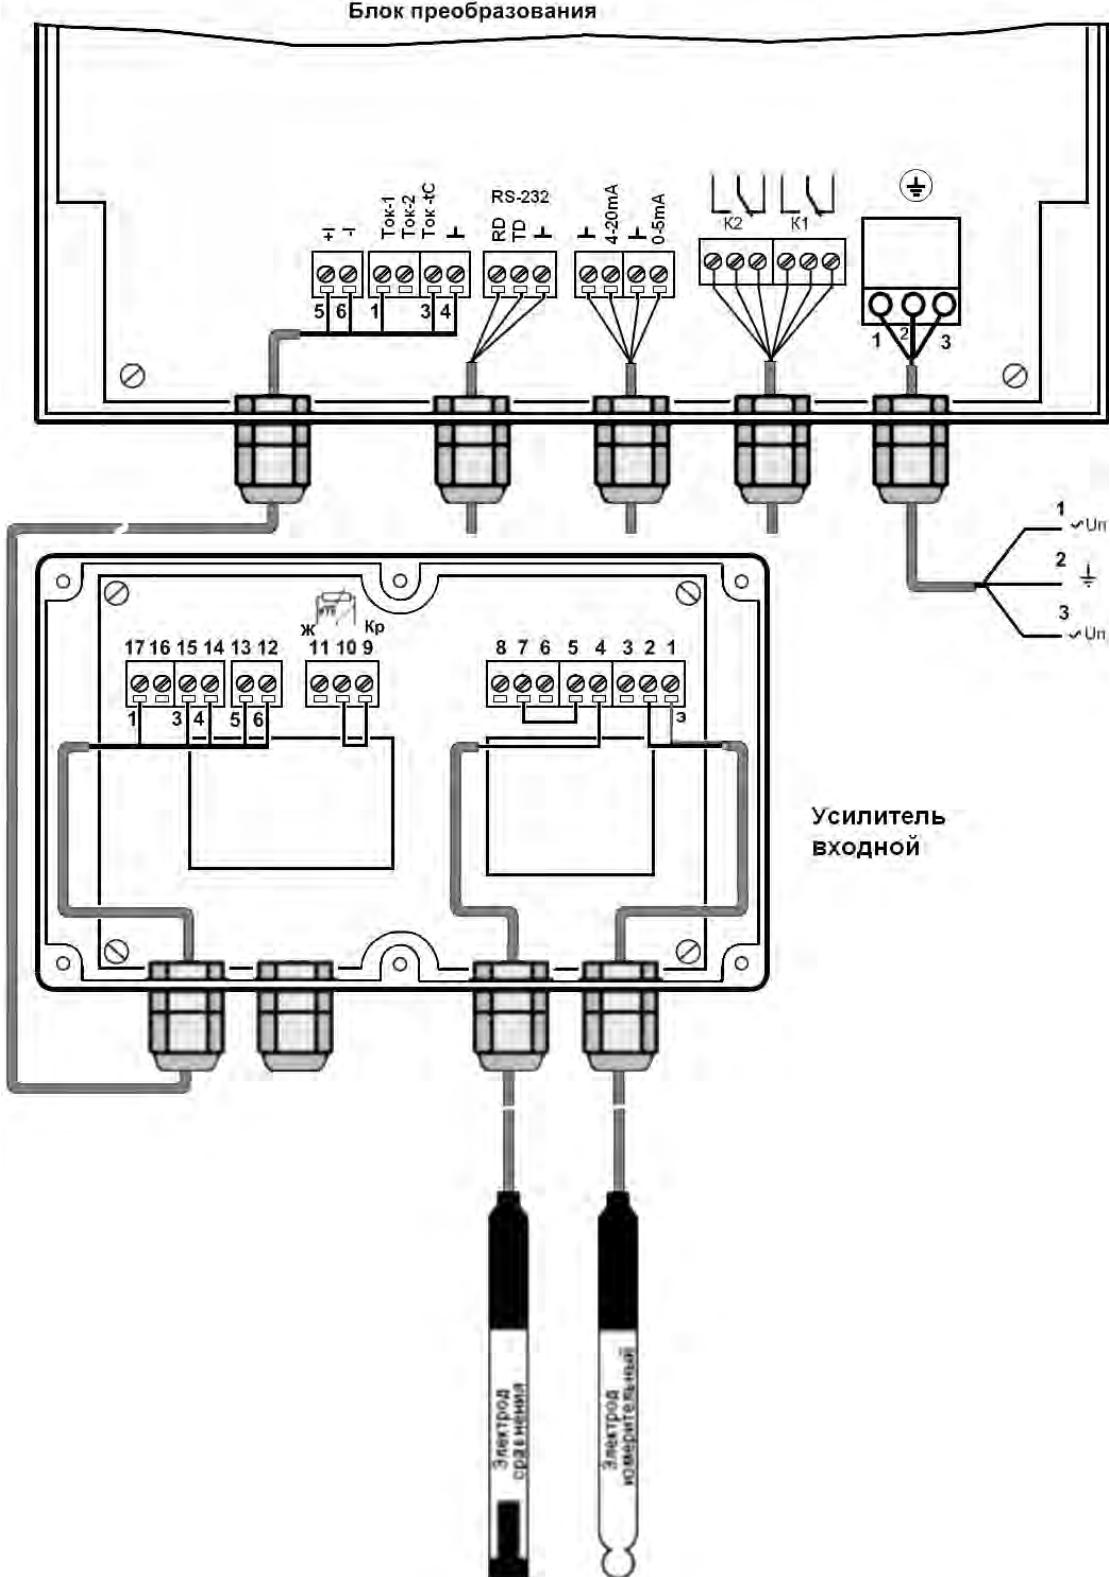


Рисунок Б.1 – Недифференциальная схема включения без применения термодатчика

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

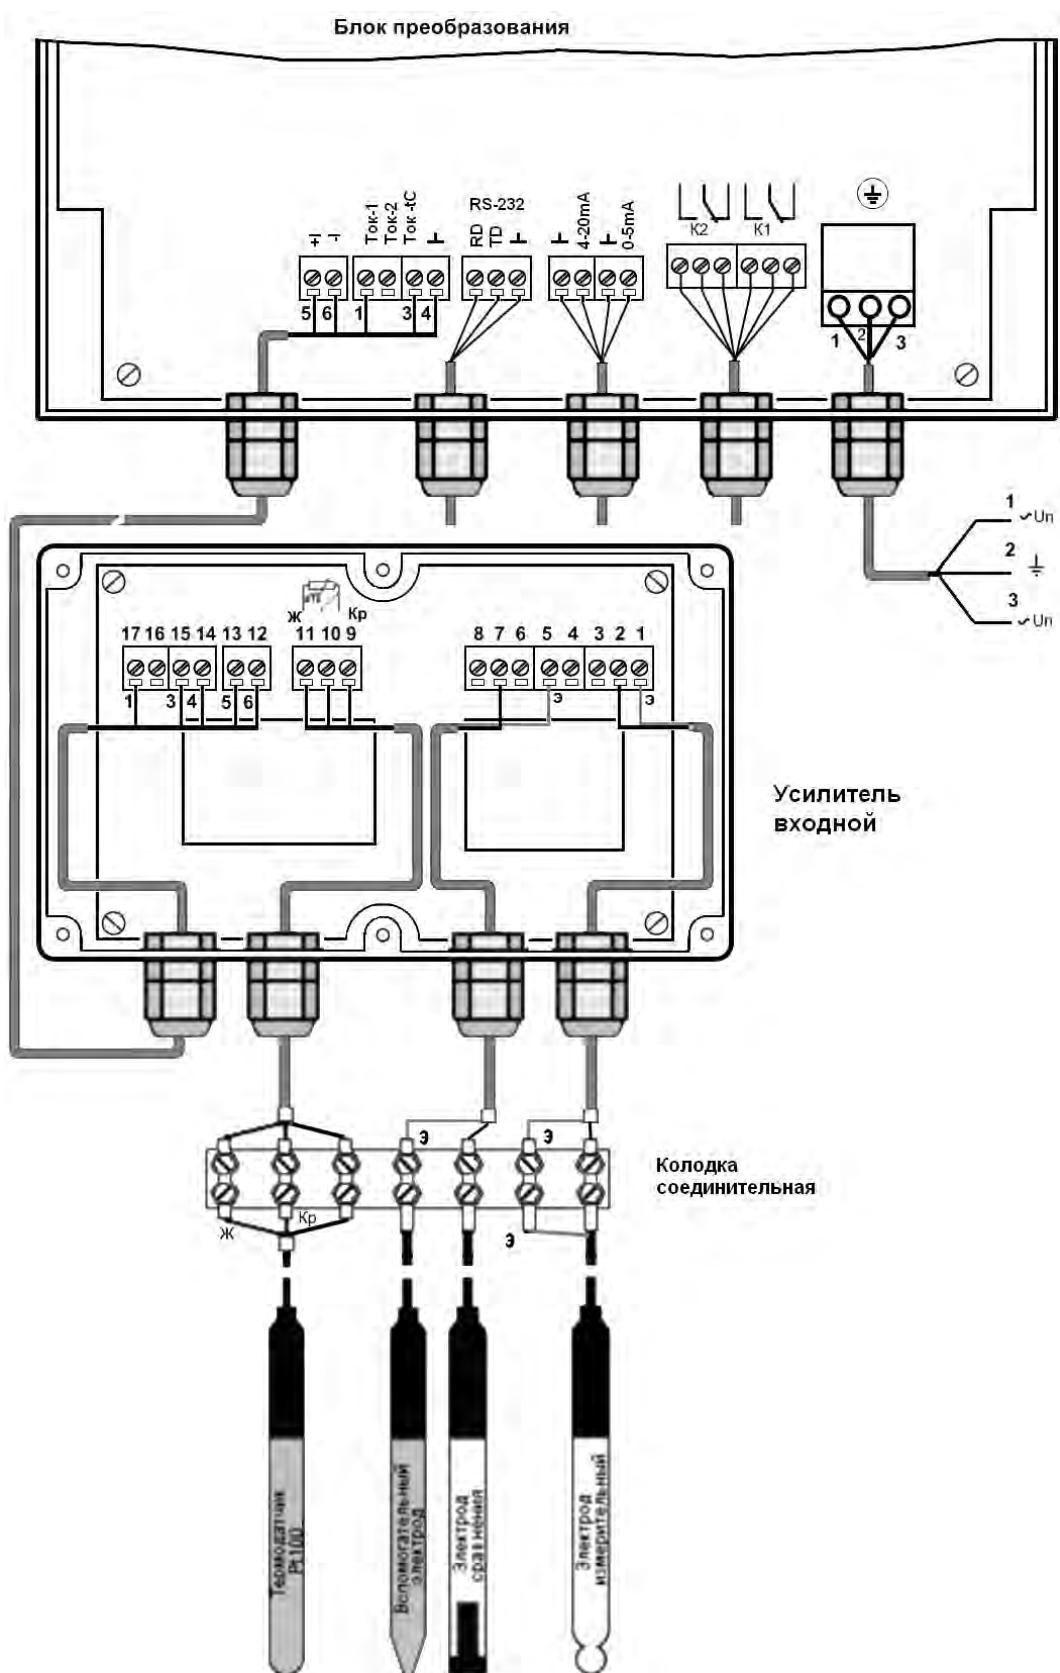


Рисунок Б.2 – Дифференциальная схема включения с применением термодатчика

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

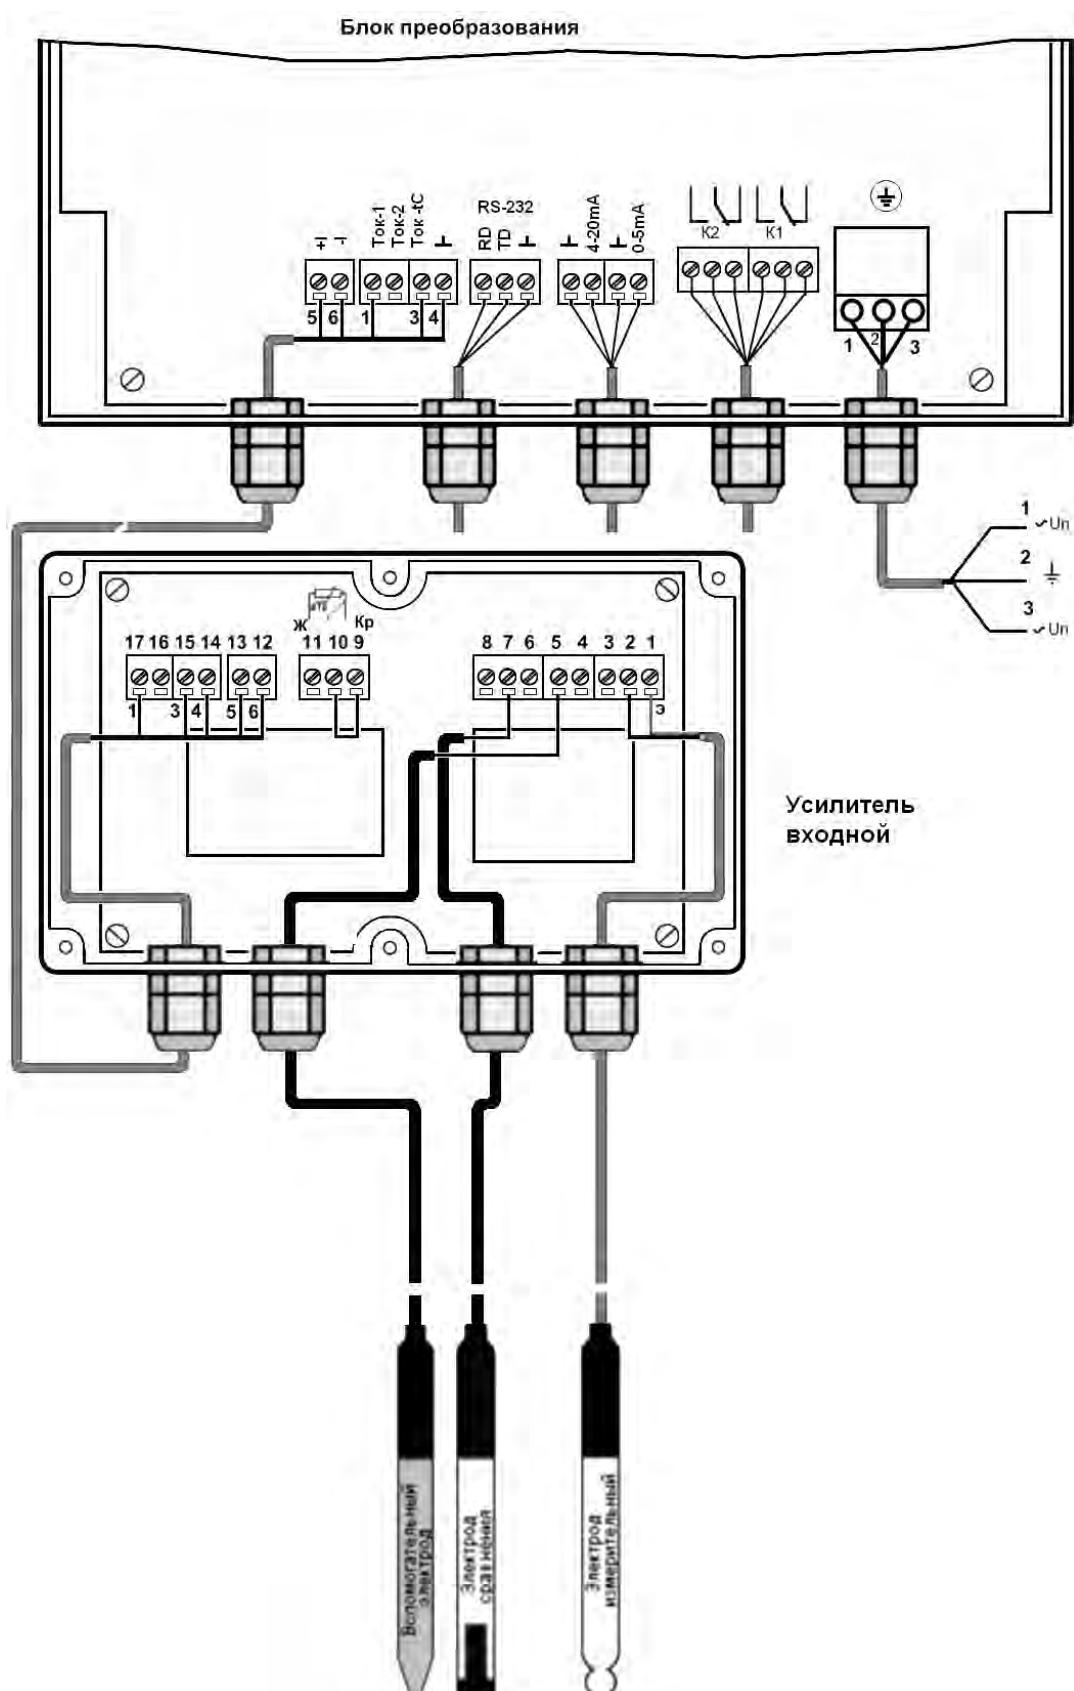


Рисунок Б.2 – Дифференциальная схема включения без применения термодатчика

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Значения pH рабочих эталонов (ГОСТ 8.134-98)

Таблица В.1


°C	0,05 моль/кг калий тетраок- салат	0,05 моль/кг калий гидро- фталат	0,025 моль/кг на- трий моногидро- фосфат + 0,025 моль/кг калий ди- гидрофосфат	0,01 моль/кг натрий тетра- борат	Кальций гидроксид (насыщенный раствор при 20 °C)
0	-	4,000	6,961	9,451	13,360
5	-	3,998	6,935	9,388	13,159
10	1,638	3,997	6,912	9,329	12,965
15	1,642	3,998	6,891	9,275	12,780
20	1,644	4,001	6,873	9,225	12,602
25	1,646	4,005	6,857	9,179	12,431
30	1,648	4,011	6,843	9,138	12,267
35	1,649	4,022	6,828	9,086	12,049
40	1,650	4,027	6,823	9,066	11,959
50	1,653	4,050	6,814	9,009	11,678
60	1,660	4,080	6,817	8,965	11,423
70	1,67	4,12	6,83	8,93	11,19
80	1,69	4,16	6,85	8,91	10,98
90	1,72	4,21	6,90	8,90	10,80
95	1,73	4,24	6,92	8,89	10,71

Значение pH при промежуточных значениях температуры определяются линейной интерполяцией.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г


(справочное)

Алгоритмы работы преобразователей

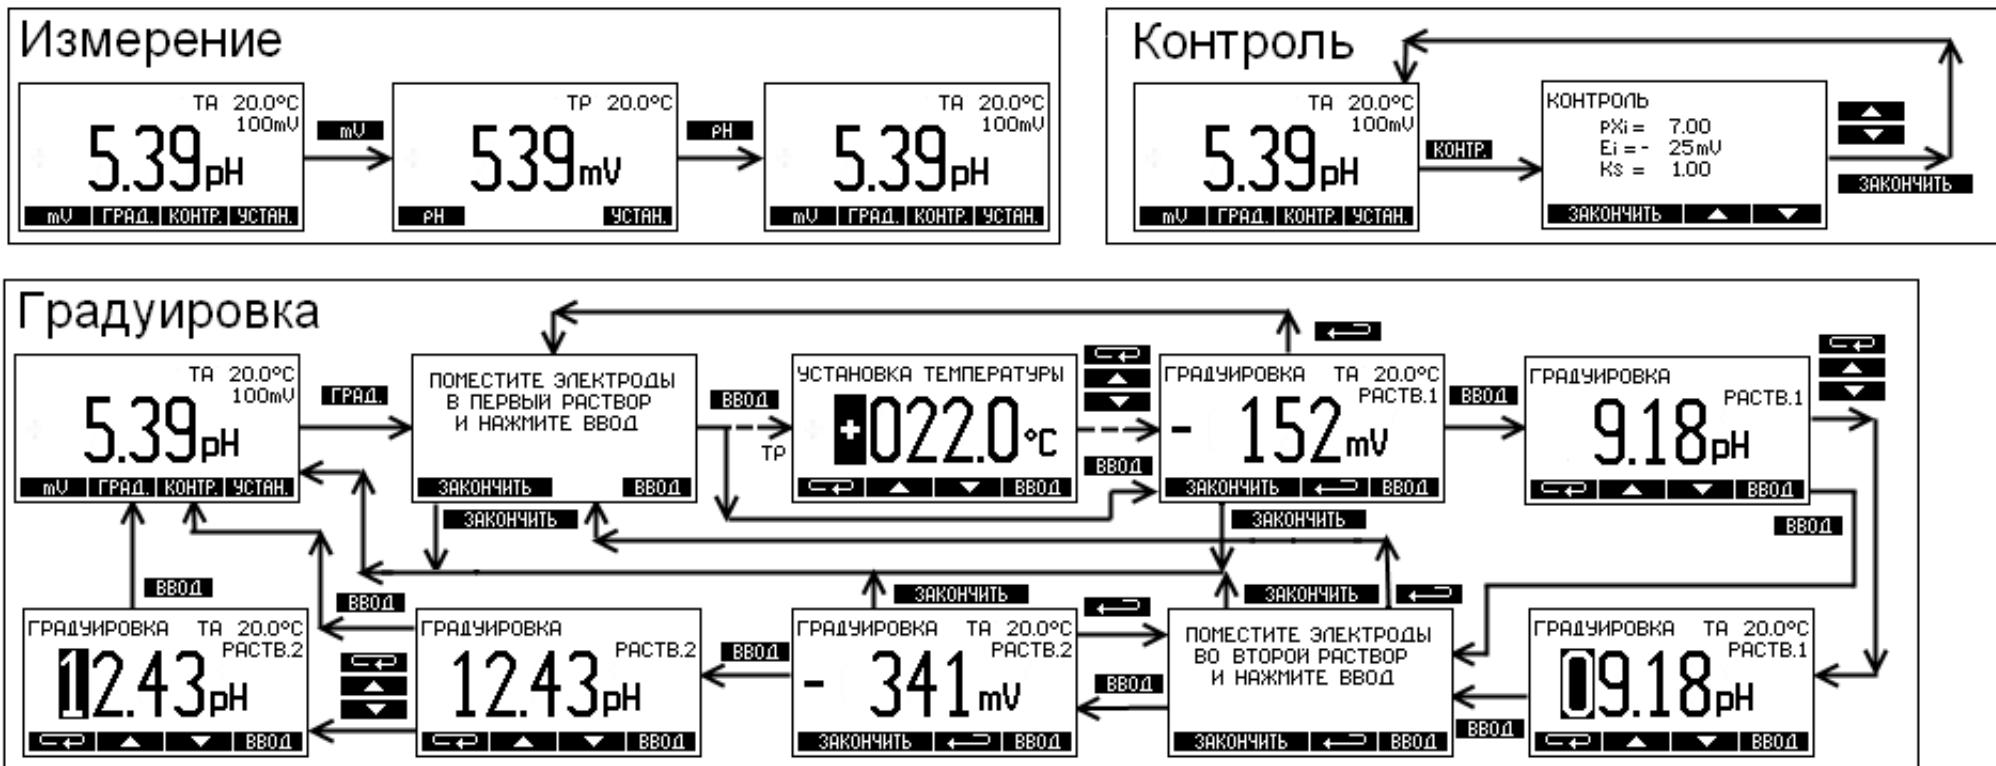

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г

Установка

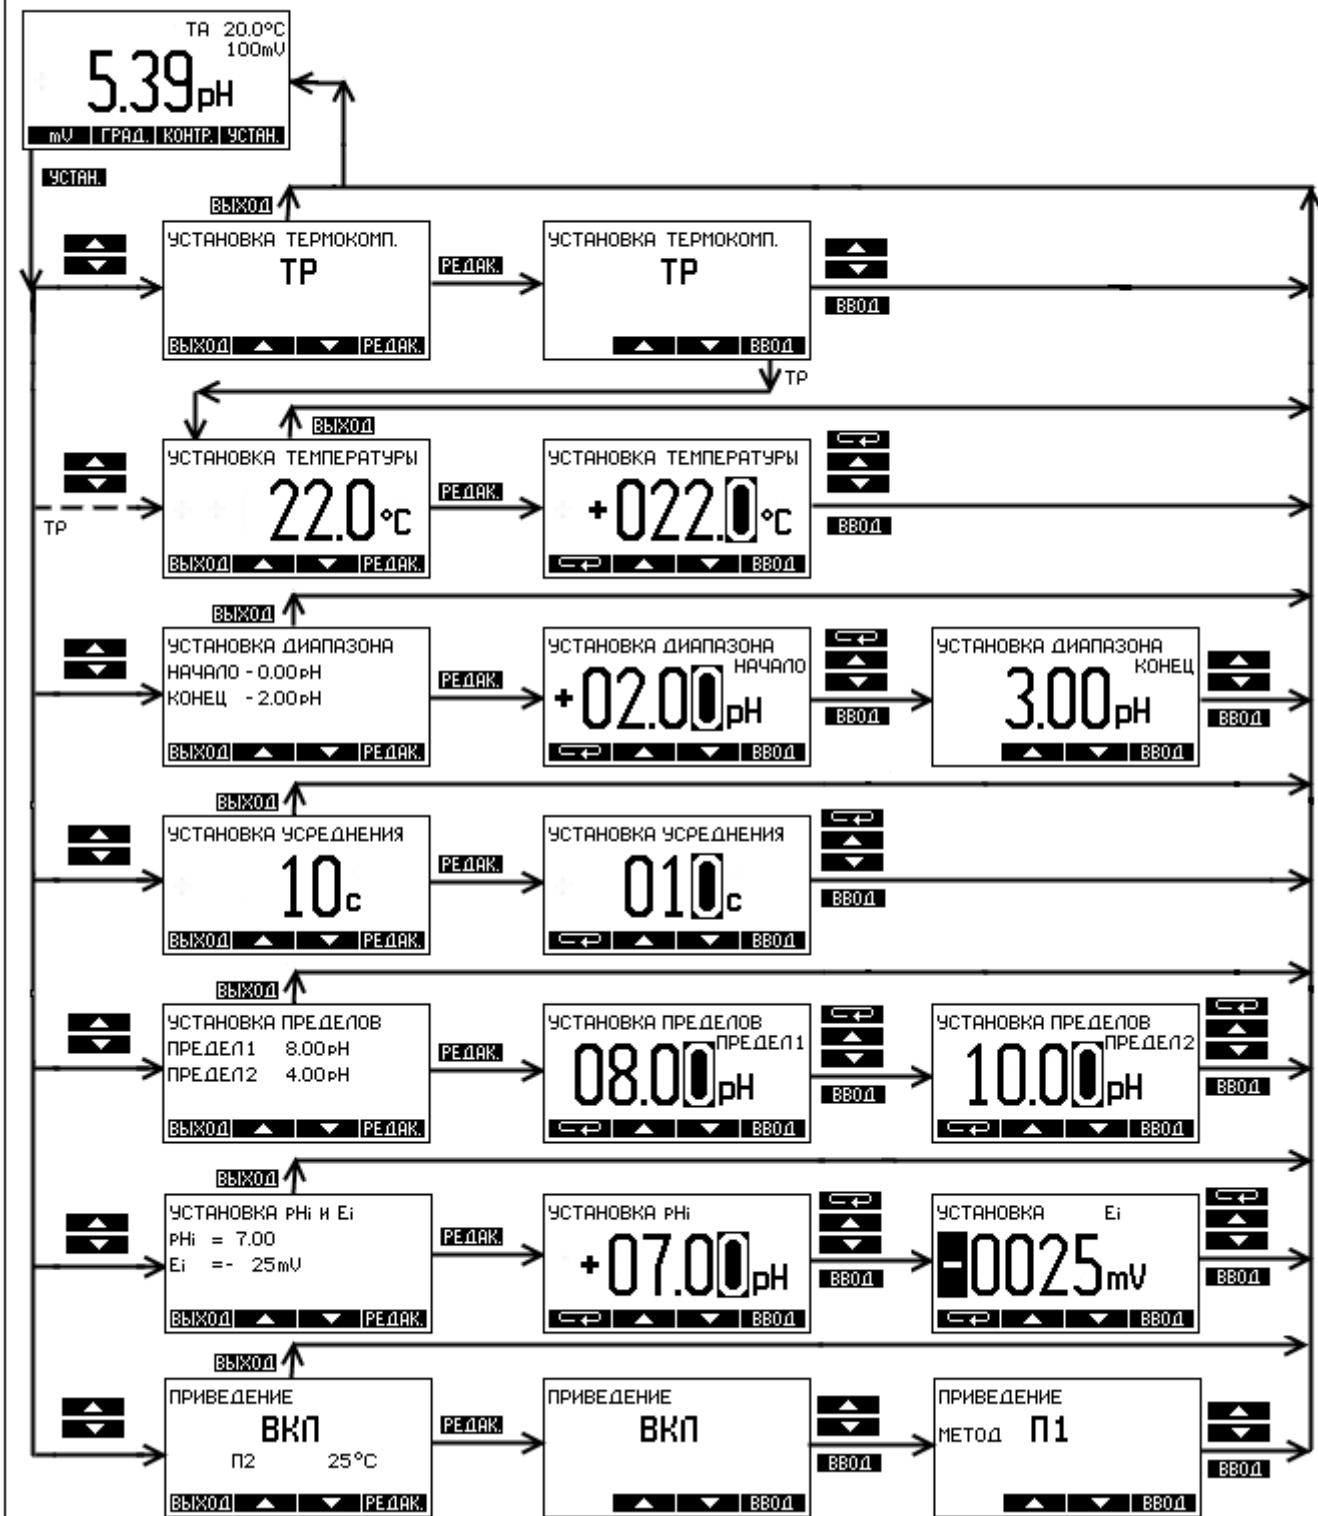



Создаем лучшее,
сохраняя хорошее

ООО «Измерительная Техника»

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://it.nt-rt.ru> || эл. почта: ita@nt-rt.ru